

Warszawa, dnia 16 .05.2017 r.

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
DZPiZ- 03/15/2017

WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na „ Dzierżawę aparatu do hemodializ w wersji podstawowej wraz z akcesoriami oraz dostawą sprzętu jednorazowego, odczynników i materiałów zużywalnych i środków do dezynfekcji potrzebnych do wykonania hemodializ na rzecz Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 15/2017).

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione przez Wykonawców w trakcie postępowania:

Dotyczy Załącznik nr 3B do SIWZ Parametry techniczne graniczne

1.Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane aparaty miały płynną regulację przepływu pompy krwi w zakresie od 15 – 600 ml / min ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający **wymaga**.

Dotyczy Załącznik nr 3B do SIWZ Parametry techniczne graniczne

2.Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane aparaty miały objętościowy pomiar ultrafiltracji ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający **wymaga**.

Dotyczy Załącznik nr 3B do SIWZ Parametry techniczne graniczne

3.Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane aparaty miały przepływ dializatu od 0-300 –500- 800 ml/ min ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający **wymaga**.

Dotyczy SIWZ 3.4.

4.Czy Zamawiający dopuści instalację i uruchomienie jednego aparatu HD do 14 dni od zawarcia umowy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający **nie wyraża** zgody.

Dotyczy SIWZ 3.4.

5.Czy Zamawiający dopuści instalację i uruchomienie jednego aparatu HD do 21 dni od zawarcia umowy?

Odpowiedź: Nie Zamawiający **nie wyraża** zgody.

Dotyczy SIWZ X.

6.Uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o jeden dzień?

Odpowiedź: Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert.

W Roz. X „ Miejsce i termin składania ofert” ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej napisami jak w rozdz. VII ust. 10 należy złożyć w Sekretariacie Zamawiającego tj.

*Szpital Czerniakowski SP ZOZ, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa,
pawilon administracyjny pok. 215 (sekretariat)
do dnia 24.05.2017 r. do GODZ. 09:00”*

Dotyczy SIWZ 1.2.4)

7.Uprzejmie prosimy o dopuszczenie usuwania awarii do 48h ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający **nie wyraża** zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dotyczy SIWZ 1.2.6)

8. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie wymiany zespołu/podzespołu na nowy w przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdz. I ust. 1.2. pkt 6), oraz Załącznikiem nr 4 do SIWZ – Projekt umowy § 5 ust.6.

Dotyczy SIWZ 1.2.8)

9. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie bezpłatnego przeszkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi Urządzenia w terminie 7 dni liczonych od dnia instalacji i uruchomienia Urządzenia ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający **wyraża zgodę** i dokonuje poniższych zmian.

W związku z powyższym:

1. Rozdz. I ust. 1.2. pkt 8) SIWZ przyjmuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie przeszkolić pracowników Zamawiającego skierowanych przez Zamawiającego do obsługi Urządzenia w **terminie 7 dni** liczonych od dnia instalacji i uruchomienia Urządzenia.”.
2. § 3 ust. 3 Projektu Umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) przyjmuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić pracowników Zamawiającego skierowanych przez niego do obsługi Urządzenia w **terminie 7 dni** liczonych od dnia instalacji i uruchomienia Urządzenia”

Dotyczy Załącznik nr 3A do SIWZ Lp5

10. Ze względu na stały brak w ofercie uprzejmie prosimy o wydzielenie koncentratów dializacyjnych (płynnych) , t.j. pozycji 5 ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający **nie wyraża** zgody.

Dotyczy Załącznika nr 3B do SIWZ Parametry techniczne graniczne Lp6

11. Czy Zamawiający dopuści aparaty do hemodializ z archiwizacją ostatniej przeprowadzonej dezynfekcji z podaniem daty, godziny i rodzaju przeprowadzonej dezynfekcji i z jakim skutkiem została przeprowadzona ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający **dopuszcza**.

Dotyczy Załącznik nr 3A do SIWZ Lp8

12. Ze względu na stały brak w ofercie uprzejmie prosimy o wydzielenie worków spustowych do linii krwi dializacyjnych 2 Litrowych , tj. pozycji 8 ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający **nie wyraża** zgody.

Dotyczy Załącznik nr 3A do SIWZ Lp12 Środki do dezynfekcji wewnętrznej i zewnętrznej.

13. Ze względu na **brak możliwości wyceny dwóch różnych dezynfektantów w jednej pozycji** Lp12 - w jednym wierszu, prosimy Zamawiającego o wydzielenie dezynfektantu zewnętrznego z Lp12 i utworzenie nowej pozycji dla środka dezynfekcji zewnętrznej ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający **wyraża zgodę** i dokonuje stosownej modyfikacji.

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 3A do SIWZ.

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2.10 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający **nie wyraża** zgody.

15. Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny

kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający **nie wyraża** zgody.

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie 2.9 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający **nie wyraża** zgody.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający tj. Szpital Czerniakowski SP ZOZ z siedzibą w Warszawie (00-739) przy ul. Stępińskiej 19/25, **dokonuje stosownej modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu nr 76481-2017 z dnia 28.04.2017 r.**

W związku z modyfikacją zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

- 1) W Rozdz.: I „Przedmiot zamówienia i obowiązki wykonawcy” ust.1 pkt. 1.2 ppkt 8 otrzymuje brzmienie: „*Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie przeszkolić pracowników Zamawiającego skierowanych przez Zamawiającego do obsługi Urządzenia w terminie **7 dni** liczonych od dnia instalacji i uruchomienia Urządzenia*”
- 2) W Rozdz.: I „Przedmiot zamówienia i obowiązki wykonawcy” ust. 3 ppkt 3.3 otrzymuje brzmienie: „*Okres trwania umowy: **od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 roku***”:
 - 1) Zamawiający dopuszcza późniejszy termin rozpoczęcia realizacji umowy, ze względu na przedłużające się postępowanie przetargowe. W sytuacji, gdy do zawarcia umowy dojdzie po dniu 01.07.2017 r., wówczas termin realizacji przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy i kończy się w dniu 30.06.2018r.
 - 2) W przypadku rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy w trakcie miesiąca, czynsz dzierżawny za niepełny miesiąc kalendarzowy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu.
- 3) W Roz. X „Miejsce i termin składania ofert” ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„*Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej napisami jak w rozdz. VII ust. 10 należy złożyć w Sekretariacie Zamawiającego tj.
Szpital Czerniakowski SP ZOZ, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa,
pawilon administracyjny pok. 215 (sekretariat)
do dnia **24.05.2017 r. do GODZ. 09:00***”
- 4) W Roz. XII „Informacje o miejscu, terminie i trybie otwarcia ofert” ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„*Publiczne otwarcie ofert w obecności przybyłych Wykonawców nastąpi:
Szpital Czerniakowski SP ZOZ, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa,
pawilon administracyjny pok. 120 (Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia).
dnia **24.05.2017 r. o GODZ. 09:15***”

W związku z modyfikacją zmianie ulegają następujące zapisy Projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ:

- a) § 3 ust. 1 Projektu Umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) przyjmuje brzmienie: „*Umowa zostaje zawarta na okres: od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 r.*”

- 1) Zamawiający dopuszcza późniejszy termin rozpoczęcia realizacji umowy, ze względu na przedłużające się postępowanie przetargowe. W sytuacji, gdy do zawarcia umowy dojdzie po dniu 01.07.2017 r., wówczas termin realizacji przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy i kończy się w dniu 30.06.2018 r.;"
- b) § 3 ust. 3 Projektu Umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) przyjmuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić pracowników Zamawiającego skierowanych przez niego do obsługi Urządzenia w terminie 7 dni liczonych od dnia instalacji i uruchomienia Urządzenia”.

Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ- „Formularz ofertowy” znajduje się do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl)

Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ- „Projekt umowy” znajduje się do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl)

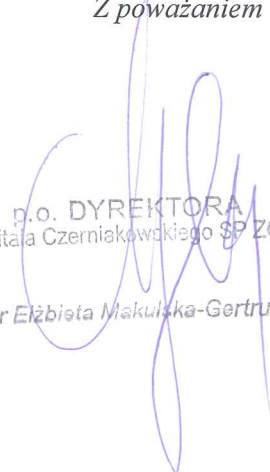
Zmodyfikowany załącznik nr 3.A do SIWZ- „Formularz asortymentowo-cenowy” znajduje się do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl)

Zmodyfikowany załącznik nr 3.B do SIWZ- „ Parametry techniczne graniczne przedmiotu zamówienia” znajduje się do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl)- zmodyfikowano pkt. 2.1 – 2.12

Zmodyfikowane ww. dokumenty stanowią integralną część udzielonych odpowiedzi.

W związku z ww. zmianami działając na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień **24.05.2017 roku** na godzinę **09.00**. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu **24.05.2017 roku** o godzinie **09.15**. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia pozostają bez zmian.

Z poważaniem


p.o. DYREKTORA
Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ
mgr Elżbieta Makulska-Gertruda

Sporządziła: Małgorzata Bauer-Dolegowska