

Warszawa, dnia 03.12.2018 r.

DZPiZ-02/82/2018

WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na: „*Zakup i dostawa stołu operacyjno – ortopedycznego z akcesoriami na blok operacyjny Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.*” (sprawa 82/2018)

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione w trakcie postępowania i dokonuje zmiany SIWZ:

Pytanie 1

DOTYCZY zapisów SIWZ pkt. XIII. ZASADY OCENY OFERT

Uprzejmie prosimy o zmianę zasad oceny ofert. Kluczową kwestią jest jakość produktu dlatego prosimy aby zwiększyć udział procentowy punktacji jakości oferowanego produktu w stosunku do ceny. Umożliwi to większą konkurencyjność pośród oferentów.

Prosimy aby zapisy wyglądały następująco:

1. Oferowana cena całkowita brutto przedmiotu zamówienia 60 %
2. Okres gwarancji 10 %
3. Jakość 30 %

Razem: 100

Odpowiedź nr 1: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w Załączniku nr 3 pkt 85 dopuści Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji maksymalnie 48 godziny od daty zgłoszenia ? Czas wymagany przez Zamawiającego jest bardzo krótki.

Odpowiedź nr 2: Tak, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w Załączniku nr 3 pkt 86 dopuści Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji bez konieczności sprowadzenia części zamiennych do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Czas wymagany przez Zamawiającego jest bardzo krótki.

Odpowiedź nr 3: Tak, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w Załączniku nr 3 pkt 87 dopuści Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji z koniecznością sprowadzenia części zamiennych do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. Czas wymagany przez Zamawiającego jest bardzo krótki.

Odpowiedź nr 4: Tak, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający w Załączniku nr 3 pkt 88 dopuści zapis w przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni roboczych, Wykonawca na czas wykonania serwisu/naprawy zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu zastępczego urządzenia o parametrach nie gorszych niż wskazanych, na swój koszt. Czas wymagany przez Zamawiającego jest bardzo krótki.

Odpowiedź nr 5: Tak, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający w Załączniku nr 3 pkt 89 dopuści zapis Jeżeli w okresie gwarancji/rękojmi wystąpi awaria urządzenia niemożliwa do usunięcia lub urządzenie będzie niesprawne pomimo wykonania uprzednio trzech napraw, Wykonawca, w terminie 14 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii, jest zobowiązany do jego wymiany na fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż określono w SIWZ. Czas wymagany przez Zamawiającego jest bardzo krótki.

Odpowiedź nr 6: Tak, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisów umowy w §5, pkt. 8, ppkt. 7 na poniższe?


7) jeżeli w okresie gwarancji wystąpi awaria przedmiotu umowy niemożliwa do usunięcia lub przedmiot umowy będzie niesprawny pomimo wykonania uprzednio trzech napraw tego samego elementu, Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii wymieni przedmiot umowy na fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.

Odpowiedź nr 7: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt Umowy.

Pytanie 8

Dotyczy załącznika nr 3 (parametry techniczne graniczne – Opis przedmiotu zamówienia):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z podstawą w kształcie litery T wyposażonej w wysokiej jakości układ jezdny składający się z 3 kół: jedno koło pojedyncze obrotowe, pozostałe dwa podwójne, nieskrętne pełniące rolę wspomagającą do jazdy na wprost? Podstawa przykrywająca w całości koła transportowe. Konstrukcja stołu w kształcie litery T jest bardzo ergonomiczna, pozwala na bardzo dobry dostęp operatora do pacjenta. Podstawa wyposażona w centralną blokadę uruchamianą dźwignią nożną, gwarantującą pewne blokowanie stołu za pomocą wysuwanych stopek – dotyczy l.p. 4-5

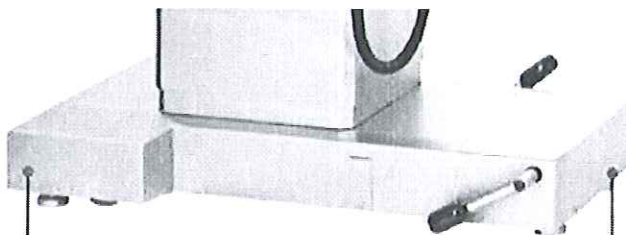

Odpowiedź nr 4: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

Konstrukcja stołu oferowanego przez Wykonawcę umożliwia stabilną jazdę na wprost bez potrzeby aktywowania blokady. Zwracamy się zatem do Zamawiającego o dopuszczenie stołu bez mechanizmu do jazdy kierunkowej uruchamianego za pomocą dźwigni nożnej lub pilota – dotyczy l.p. 6

Odpowiedź nr 4: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu operacyjnego o szerokości z szynami bocznymi – 560mm? – dotyczy l.p. 8

Odpowiedź nr 10: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonego w pilot bez podświetlenia, wyposażony w czytelne piktogramy przedstawiające poszczególne funkcje stołu? – dotyczy l.p. 16

Odpowiedź nr 11: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w podglówek regulowany manualnie wspomagany sprężynami gazowymi – tylko w jednej płaszczyźnie? Zakres regulacji - 45stopni do +45stopni ? – dotyczy l.p. 18, 21

Odpowiedź nr 12: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w:

- podnóżki 1-płaszczyznowe regulowane ręcznie, wspomagane sprężynami gazowymi, o regulacji kąta rozchylenia podnóżków 180stopni

Lub

- podnóżki 2-płaszczyznowe regulowane mechanicznie, o regulacji kąta rozchylenia podnóżków 180stopni(dotyczy l.p. 18)

Odpowiedź nr 13: Zamawiający wyraża zgodę na podnóżki 2 – płaszczyznowe.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w segment nożny regulowany ręcznie, wspomagany sprężynami gazowymi – w zakresie +20° do -90°? – dotyczy l.p. 20, 22

Odpowiedź nr 14: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, który nie będzie wyposażony w funkcję zapamiętywania i łatwego wywoływania często używanych przez Użytkownika pozycji? – dotyczy l.p. 26

Odpowiedź nr 15: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z zakresem regulacji wysokości (bez materaca) 665-1115mm? – dotyczy l.p. 26

Odpowiedź nr 16: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z zakresem regulacji pleców -35 stopni do +75stopni? – dotyczy l.p. 29

Odpowiedź nr 17: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z blokadą ruchów, ale bez sygnalizacji? – dotyczy l.p. 31

Odpowiedź nr 18: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu bez systemu i czujnika antykolizyjnego? – dotyczy l.p. 32, 33

Odpowiedź nr 19: Funkcjonalność opisana w punkcie 32 i 33 jest parametrem punktowanym a nie bezwzględnie wymaganym.

Pytanie 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, który nie jest wyposażony w system powolnego startu ruchów stołu. Oferowany stół pozwala na precyzyjne ustawienie funkcji stołu? – dotyczy l.p. 42

Odpowiedź nr 20: Pytanie dotyczy punktu 43. Funkcjonalność opisana w punkcie 43 jest parametrem punktowanym a nie bezwzględnie wymaganym.

Pytanie 21

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny z 4 pojedynczymi kołami o średnicy 100 mm zapewniającymi płynne i łatwe manewrowanie stołem?

Odpowiedź nr 21: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości stół operacyjny o konstrukcji nie wymagającej dodatkowych rozwiązań takich jak piąte koło kierunkowe lub napęd własny ponieważ zastosowane rozwiązania umożliwiają łatwe i precyzyjne manewrowanie stołem na sali operacyjnej oraz w trakcie jazdy na wprost?

Odpowiedź nr 22: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 23

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości stół operacyjny z pilotem przewodowym? Pozwoli to obniżyć koszty ponadto liczne doświadczenia wskazują, że w trakcie pracy na sali operacyjnej dochodziło do zgubienia pilota.

Odpowiedź nr 23: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 24

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości stół operacyjny z segmentem nożnym dzielonym na dwie części wzdłużnie z zakresem elektrohydraulicznej regulacji kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 90⁰ do 80⁰ co jest parametrem lepszym od wymaganego?

Odpowiedź nr 24: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 25

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości stół operacyjny o konstrukcji nie wymagającej zabezpieczenia obudowy kolumny przed uszkodzeniem?

Odpowiedź nr 25: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości stół operacyjny o konstrukcji umożliwiającej maksymalne obciążenie stołu w zakresie 230- 460 kg w zależności od jego konfiguracji i ustawienia?

Odpowiedź nr 26: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 27

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości stół operacyjny o konstrukcji nie wymagającej dodatkowe funkcji powolnych ruchów ponieważ wszelkie regulacje stołu odbywają się ruchami płynnymi i precyzyjnymi?

Odpowiedź nr 27: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 28

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości stół operacyjny z podpórką do operacji ręki mocowaną do listwy bocznej stołu, podpórka z materacem o wymiarach min. 350mm x 800mm, podpórka z jednym wspornikiem z regulacją wysokości oraz ze stabilną podstawą w pełni przezierna dla promieni RTG? Takie rozwiązanie spełnia wymóg przezierności a znacząco obniża koszt zakupu stołu.

Odpowiedź nr 28: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.


Pytanie 29

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości stół operacyjny z pasami pacjenta o regulowanej długości?

Odpowiedź nr 29: Tak, Zamawiający dopuszcza./dopuszcza

Pytanie 30


Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości stół operacyjny z lekką płytą transferową pod nogi do ułożenia pacjenta do znieczulenia?/ dopuszcza

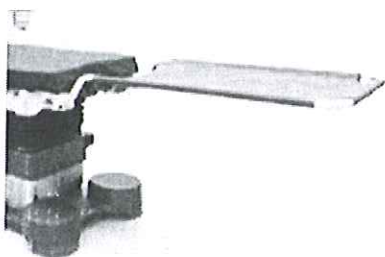

Odpowiedź nr 30: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 31

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości stół operacyjny z jednoczęściowym, profilowanym materacem do pozycji brzusznej?

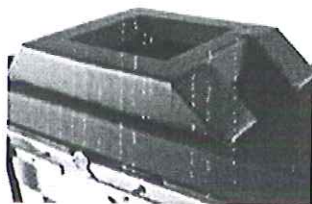

Odpowiedź nr 31: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Zmodyfikowany Załącznik 3 do SIWZ „Parametry Techniczne” oraz Załącznik 4 do SIWZ-
projekt umowy znajduje się do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego
(www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem


CZŁONEK ZARZĄDU
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Damian Raczkowski

Sporządziła: Małgorzata Bauer-Dołęgowska

PROKURENT
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.


Dominika Kołodziej

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
KIEROWNIK


Anna Kwrek-Koczkodaj